



Nova Friburgo, 12 de maio de 2025.

MEMO Nº 006/2025

De: Área Técnica de DANT - Doenças e Agravos Não Transmissíveis

Ricardo Claus Armond Bravo

Para: Comissão de Pregão 2 Prefeitura de Nova Friburgo

Assunto: Pregão Eletrônico nº 90.033/2025-

Prezado(s),

Conforme previsto no edital, há dois itens relacionados às tiras de glicemia: o item 03 refere-se à cota reservada e o item 04 à cota principal, conforme demonstrado a seguir:

03	332344	Tiras para determinação de glicemia quantitativa em sangue venoso e arterial para pacientes adultos e neonatos desde a primeira hora de vida, aplicável para punção capilar em sensor amperométrico ou fotométrico, glicose desidrogenase, tamanho da amostra igual ou inferior a 04 (quatro) microlitros, tempo de leitura máximo de 30 (trinta) segundos para uso em monitor de glicemia compatível, faixa de hematócrito de 20% a 70%, e que o resultado não interfira em oxigênio hospitalar (po2), intervalo de medição compreendido entre 10 e 600 mg/dl, possibilidade de realizar análise de controle de qualidade em no mínimo 02 (dois) níveis. Embalagens com 50 (cinquenta) tiras. Deverá ter certificado de boas práticas de fabricação emitido pela ANVISA e estar de acordo com isso 15197-2013.	Unid.	163.994
----	--------	---	-------	---------

COTA PRINCIPAL				
04	332344	Tiras para determinação de glicemia quantitativa em sangue venoso e arterial para pacientes adultos e neonatos desde a primeira hora de vida, aplicável para punção capilar em sensor amperométrico ou fotométrico, glicose desidrogenase, tamanho da amostra igual ou inferior a 04 (quatro) microlitros, tempo de leitura máximo de 30 (trinta) segundos para uso em monitor de glicemia compatível, faixa de hematócrito de 20% a 70%, e que o resultado não interfira em oxigênio hospitalar (po2), intervalo de medição compreendido entre 10 e 600 mg/dl, possibilidade de realizar análise de controle de qualidade em no mínimo 02 (dois) níveis. Embalagens com 50 (cinquenta) tiras. Deverá ter certificado de boas práticas de fabricação emitido pela ANVISA e estar de acordo com isso 15197-2013.	Unid.	1.658.166

Diante do exposto, a empresa **DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS** está apta para o fornecimento de insumos no contexto do Pregão Eletrônico 34.876/2024, Processo Administrativo 34.876/2025, no que diz respeito à cota principal.

Da mesma forma, que a empresa BRAGA E NETO COM. E REP. EIRELI ME. também está apta para o fornecimento de insumos no contexto do Pregão Eletrônico 34.876/2024, Processo Administrativo 34.876/2025, no que se refere a cota reservada.

Considera-se ainda que ambas as empresas oferecem produtos do mesmo fabricante, da marca ROCHE, com as especificações descritas a seguir.

Volume de amostra

2µL de sangue total. 1µL de sangue total, quando a amostra é aplicada no centro da tira reagente. Pequeno volume adequado às condições de coleta no ambiente hospitalar e domiciliar.


Tipo de amostra

- Sangue total: capilar, venoso, arterial ou neonatal.
- Garante a utilização prática e segura por todos os setores do hospital.

Faixa de hematócrito

- 20 a 55% (coleta com a tira dentro do monitor).
 - 20 a 70% (coleta com a tira fora do monitor).
- A faixa ampla de hematócrito garante a exatidão, precisão e qualidade dos resultados. A dosagem feita com a tira fora do monitor oferece mais segurança, por exemplo, nas determinações feitas com as amostras de neonatos e/ou pacientes em UTI, que normalmente apresentam faixas de hematócritos alteradas.

Dessa forma, fica evidente que os insumos da marca ACCU CHEK ACTIVE, fabricados pela ROCHE, atendem de maneira satisfatória às exigências do edital em questão.

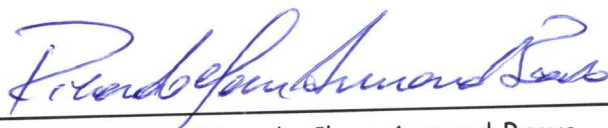

Ricardo Claus Armond Bravo
Coordenador DANTE
Mat. 299.098



Ana Clara Iorio
Farmacêutica
CRF-RJ 16451
Matrícula 063497

Ana Clara Iorio
Coordenação de Assistência Farmacêutica
Mat. 062.342