

Assunto: **RES: Best Fabril**
De: Jaqueline Jorge - Best Fabril <vendas5@bestfabril.com.br>
Para: <cintia.vendas@fabrimedx.com.br>, 'Sac - BestFabril' <sac@bestfabril.com.br>
Cc: 'Fabrimedhospitolar' <fabrimedhospitolar@gmail.com>, 'Debie' <eibed.licitacao@gmail.com>
Data: 03/07/2023 11:51



Bom dia Cíntia, tudo bem?

Venho por meio desse e-mail pedir minhas sinceras desculpas pelo o ocorrido.

Como nós conversamos por telefone, não vamos conseguir lhe atender com o valor do avental passado no orçamento, pois está divergente.

Estava analisando a proposta enviada para colocar o pedido de amostra, quando constatei um erro grave no valor do AVENTAL CIRURGICO MANGA LONGA PUNHO DE ELASTICO SMS PP40 TIRAS AZUL TAM M PCT C/10 UN que estava com o preço bem menor por ser pacote, o valor correto seria R\$ 38,00 cada pacote.
Peço desculpas por esse erro.

Quaisquer dúvidas estou à disposição.

Atenciosamente;




De: cintia.vendas@fabrimedx.com.br <cintia.vendas@fabrimedx.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 30 de junho de 2023 14:23
Para: Jaqueline Jorge - Best Fabril <vendas5@bestfabril.com.br>; sac@bestfabril.com.br
Cc: Fabrimedhospitolar <fabrimedhospitolar@gmail.com>; Debie <eibed.licitacao@gmail.com>
Assunto: Re: Best Fabril




Boa tarde,

Prezada Jaqueline!

Conforme prints abaixo você nos confirmou a informação do avental de vocês serem hidro-repelente.

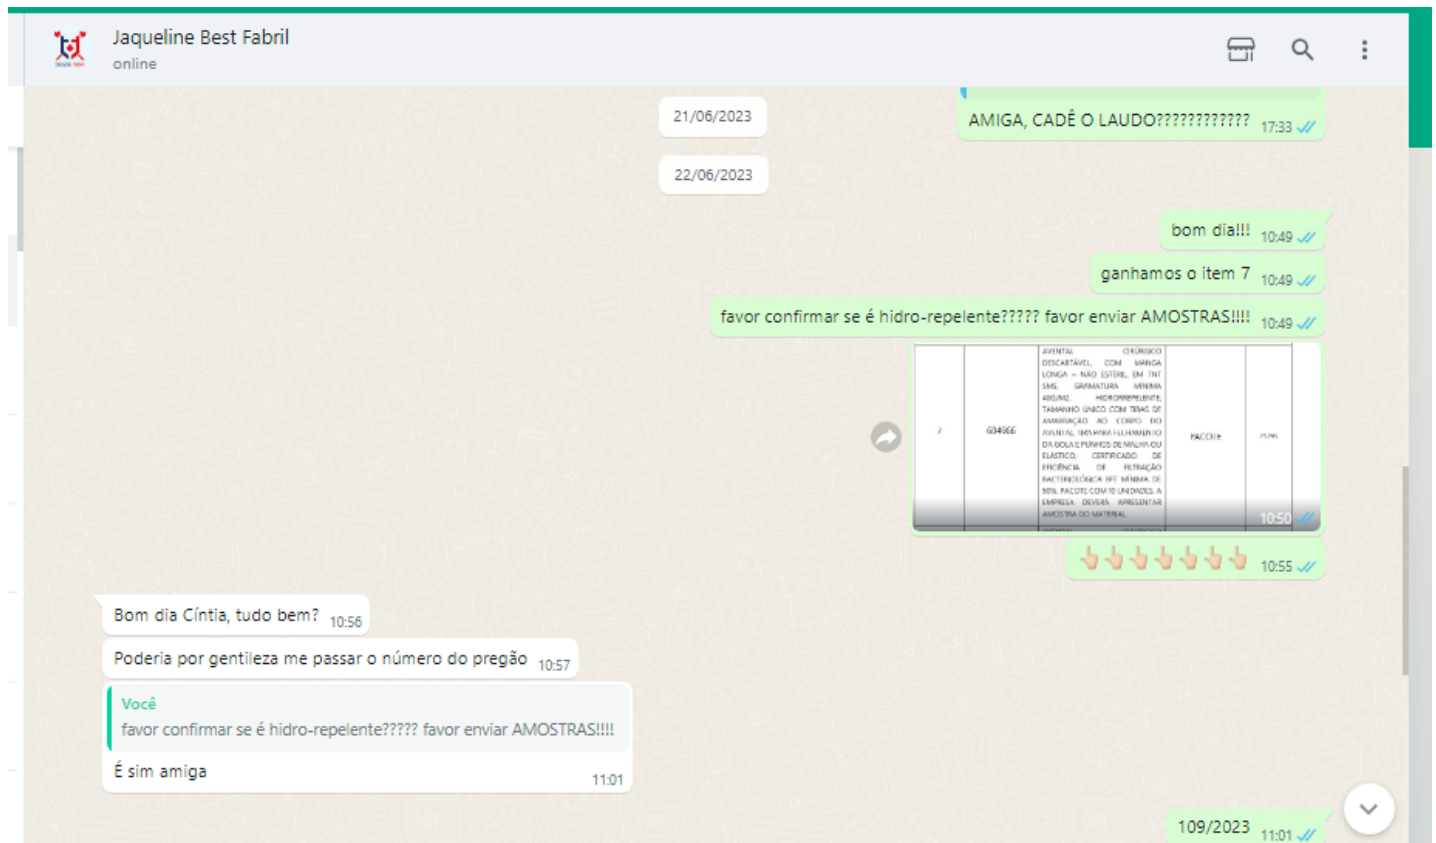

Logo, enviei várias solicitações de amostra conforme abaixo desde o dia 21/06 e temos que atender ao cliente porque estamos tratando de cliente público e poderemos ser penalizados pelo não envio das amostras conforme já elucidamos a vocês.

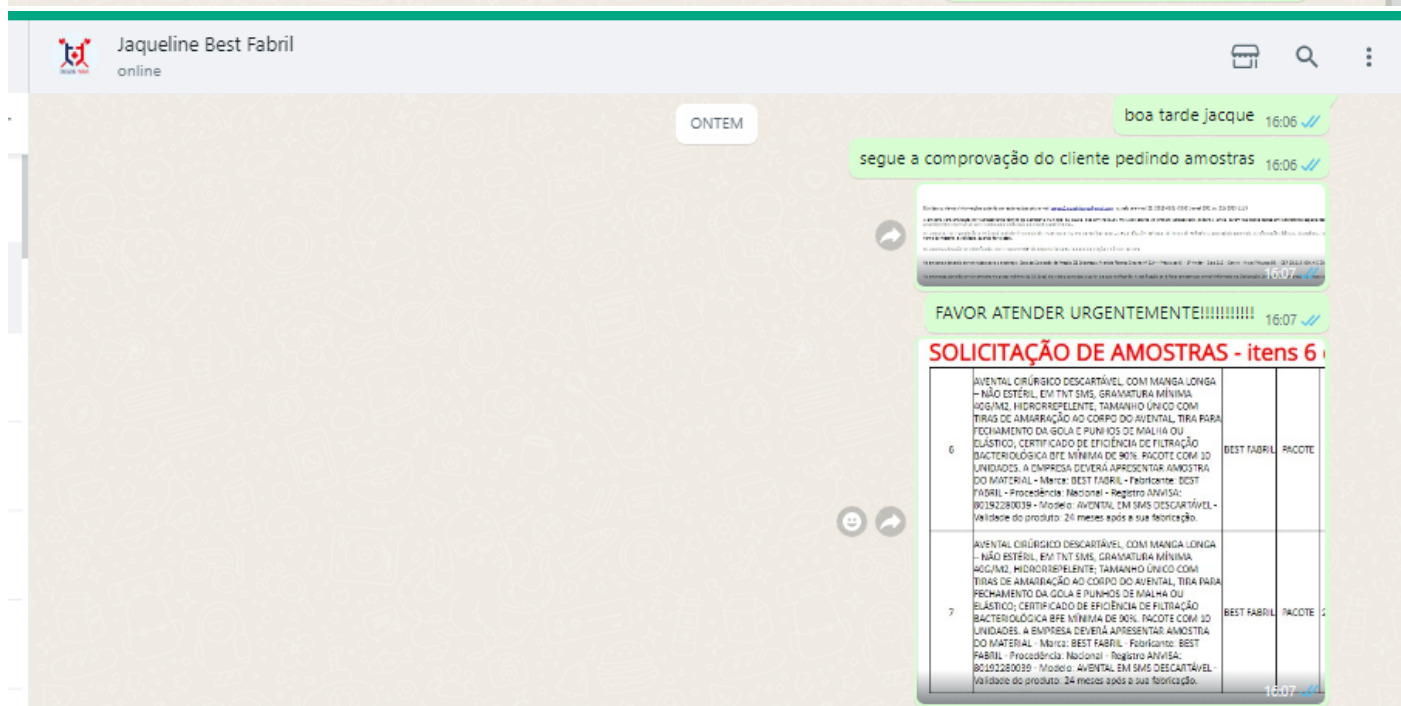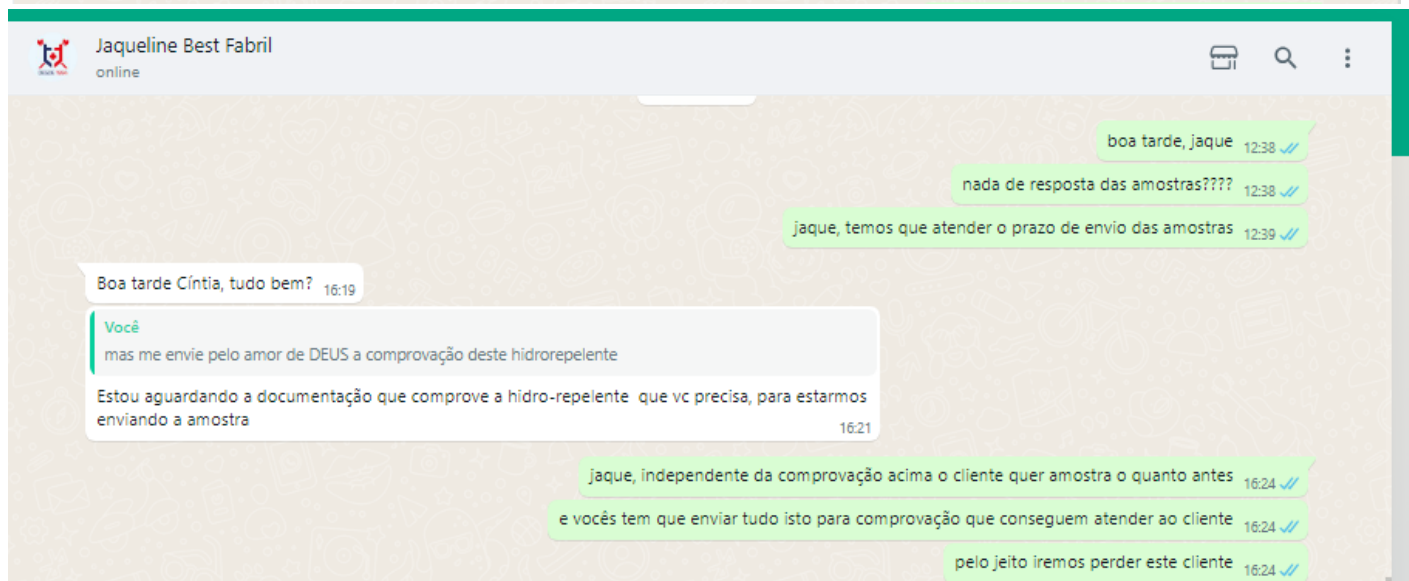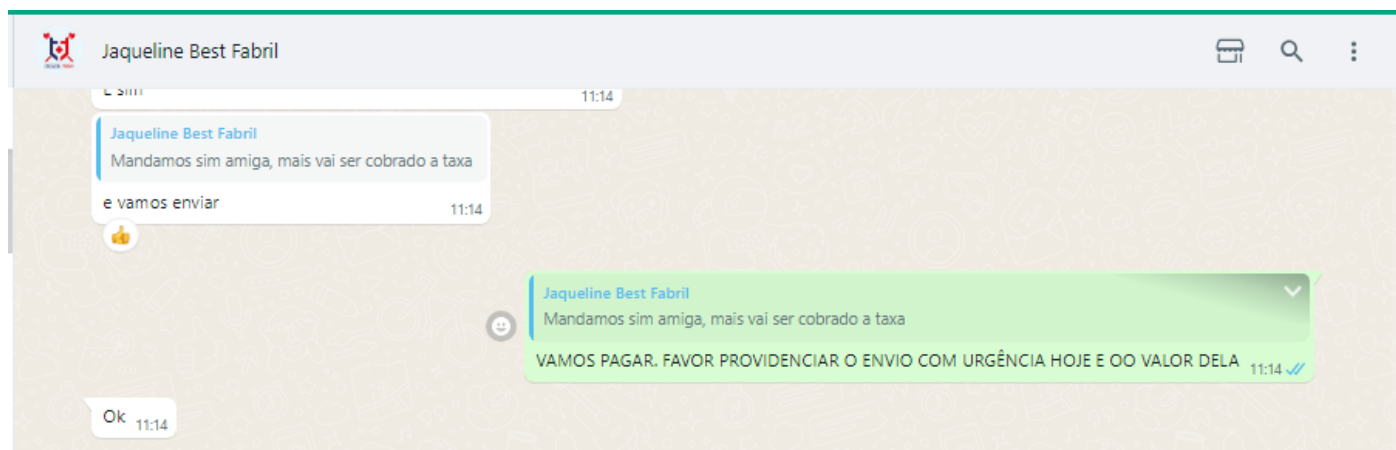

Contudo, peço por favor que nos envie as amostras para que não sejamos punidos devido ao não atendimento ao edital.

Desde já agradeço pela colaboração e fico no aguardo de um feedback!

At.te.,



Em 30/06/2023 13:55, Jaqueline Jorge - Best Fabril escreveu:

Boa tarde Cíntia, tudo bem?

Venho por meio desse e-mail informar, que nós entramos em contato com o responsável para comprovação do HIDRO REPELENTE, mas não recebemos o retorno. Nesse caso não conseguimos atender a sua solicitação de amostra, como vc me informou tem que estar tudo dentro dos conformes.

Quaisquer dúvidas estou à disposição.

Atenciosamente;



Jaqueline Souza

Departamento Comercial

☎ 55 (19) 3464-9797 | 📞 55 19 99191-2108

💻 vendas7bestfabril | 🌐 bestfabril.com.br

📘 best.fabril | 📷 best.fabril